

Łódź, dnia 03.06.2014r.
Nr sprawy 62/ZP/2014

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek wysokospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek wysokospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechanicznym skracaniem i wydłużaniem leża o 200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 2

dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzi regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-40°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi umożliwiającymi opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz blokowanie na dwóch różnych wysokościach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

dotyczy: pakiet nr 2 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

dotyczy: pakiet nr 2 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 820 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

dotyczy: pakiet nr 2 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji części nożnej w zakresie 0-40°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

dotyczy: pakiet nr 2 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.
Czy Zamawiający może sprecyzować czy łóżko ma być wyposażone w sterowanie nożne (tzw. panel nożny) czy też nie. Zapis w punkcie 22 tabeli jest niejasny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka wyposażonego w sterowanie nożne regulacji wysokości zabezpieczone przed nieumyślnym uruchomieniem.

Pytanie nr 9

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko z możliwością manualnego przedłużenia leża o 150mm? Jest to rozwiązanie powszechnie spotykane i w żaden sposób nie ograniczające funkcjonalności łóżka. Ponadto, funkcja ta jest wykorzystywana rzadko, a więc nie ma potrzeby aby była realizowana elektrycznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 10

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, w którym regulacja segmentu uda i podudzia realizowana jest w zakresie od 0 do 32°? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do ułożenia nóg pacjenta w wygodnej pozycji terapeutycznej, a poza tym różnica rzędu 3° jest niezauważalna w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 11

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, w którym segment podudzia regulowany jest manualnie za pomocą systemu zapadkowego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i nie ma potrzeby aby dany segment był regulowany elektrycznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którym blokada poszczególnych funkcji realizowana jest z poziomu panelu sterującego, a więc nie z barierki? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta – tylko personel medyczny powinien mieć dostęp do selektywnej blokady funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko z regulacją wszystkich elektrycznych funkcji z centralnego panelu sterowania dla personelu oraz z regulacją: oparcia pleców, nóg, wysokości, autokontur, pozycji mobilizacyjnej i przyciskiem pamięci dowolnego ułożenia z obustronnych paneli wbudowanych w barierki boczne? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż niektóre funkcje jak: pozycja Trendelenburga czy szokowa mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i nie powinny być dostępne do ich samodzielnego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego konstrukcja barierki umożliwia zablokowanie ich na dwóch różnych wysokościach? Bariereki i ich mechanizm został zaprojektowany tak, aby zabezpieczać pacjenta w pozycji leżącej, siedzącej i umożliwić pacjentowi zejście z łóżka, co jest w tym przypadku zagwarantowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 – Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko z możliwością pomiaru masy z dokładnością do 500g? Jest to wartość wystarczająca do skutecznego monitorowania wagi pacjenta i większa dokładność nie jest konieczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2 - Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, w którym regulacja wysokości leża odbywa się w zakresie od 430mm do 830mm? Wysokość minimalna leża na poziomie 430mm jest zgodna z normami bezpieczeństwa odnoszącymi się do łóżek szpitalnych i gwarantuje łatwe wchodzenie i schodzenie z łóżka pacjentom o niskim wzroście.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

dotyczy: przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2 - Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez łóżko obciążalności w pozycji horyzontalnej na poziomie min. 400kg? Jest to zapis, który nie znajduje uzasadnienia w praktyce użytkowej – najważniejsze jest obciążenie gwarantujące regulacje wszystkich funkcji łóżka, które w oferowanym łóżku jest zgodne z wymaganym i stoi na poziomie 230kg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 1 i 9. Czy Zamawiający dopuści wysokospecjalistyczne łóżko przeznaczone na oddziały Intensywnej Terapii i Anestezjologii o konstrukcji opartej na kolumnach prostopadłościennych usytuowanych za kotłami jezdnymi w celu zapobiegania uszkodzenia kolumn? Kolumny łatwe w dezynfekcji. Łóżko o konstrukcji stabilnej bez możliwości wykonywania przechyłów bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 19

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łóżka którego regulacja wydłużenia/ skracania leża odbywa się w sposób manualny, rozwiązania tańsze od regulacji elektrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 20

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na elektryczną regulację segmentu podudzia w zakresie 0°-23°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 21

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 29. Prosimy o doprecyzowanie o jakie wskaźniki chodzi?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka wyposażonego we wskaźniki pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na segmentach leża.

Pytanie nr 22

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości blokady panelu który jest obsługiwany jedynie przez personel medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 23

dotyczy: pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Punkt 40. Czy Zamawiający dopuści materac o maksymalnym obciążeniu statycznym 250kg i obciążeniu terapeutycznym, popartym przykładami klinicznymi, wynoszącym 150kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 24

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łóżka o szerokości 100cm z podniesionymi barierkami a 105,5 z barierkami złożonymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łóżka opartego na konstrukcji pantografu podpartego w 4 niezależnych punktach gwarantującego stabilność i zapewniającego bezpieczeństwo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 12 i 16. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym sterowanie funkcji autokonturem odbywa się z poziomu paneli wbudowanych w bariery boczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wychyleniu sekcji plecowej w zakresie 0° - 25° ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści łóżko o kącie wychylenia sekcji nożnej w zakresie 0° - 65° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 29

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z autoregresją jedynie segmentu pleców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną pozycji Anty – i Trendelenburga w zakresie (-12°) - 12° ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 20 i 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaproponowane rozwiązanie posiadało sterowaną manualnie funkcję CPR poziomującą segment oparcia, z powodów bezpieczeństwa, jako iż jest to funkcja ratująca życie, która powinna być dostępna bez względu na inne czynniki takie jak chociażby naładowany akumulator?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulowaną pozycją antyszokową wymagającą kombinacji kilku funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 23,24,25. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z selektywną blokadą funkcji elektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie technologiczne systemu jezdnego bez konieczności 5 koła, która zwiększa koszty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 32 i 38. Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością ustawienia dwóch trybów pracy: Ciągłego Niskiego Ciśnienia lub Zmiennego Niskiego Ciśnienia dając tym samym szersze zastosowania terapeutyczne? Materac pracujący w trybie napęnlania komór 1:2 w cyklu 10-25 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny przewodlężynowy bez wskaźnika podłączenia poduszki oraz wskaźnika CPR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

dotyczy: pakiet nr 2: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Punkt 39. Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trybie transportowym 10 godzin zachowując w tym czasie całkowitą funkcjonalność?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy SIWZ, rozdział II.1

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

W przypadku sprzętu importowanego, wykonywanego na zamówienie wydłużenie terminu realizacji jest niezwykle celowe. W przypadku braku zgody na wydłużenie terminu realizacji Wykonawca będzie zmuszony w kalkulować w cenę koszt ewentualnych kar umownych za opóźnienia w dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy załącznik nr 3 oraz 9 do SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taką propozycję.

Pytanie nr 40

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 3 pakiet 1, pkt. 4 w „Warunki gwarancji” oraz pakiet 2, pkt. 4 w „Warunki Gwarancji”

Czy Zamawiający zechce zmienić zapis pkt. 4 Załącznika nr 3 w zakresie pakietu nr 1 na:

„maksymalnie trzy naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji po których niesprawny podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku dwukrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosowej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 41

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 3 pakiet 1 i pakiet 2, pkt 7 w „Warunki gwarancji”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy: załącznik nr 9, wzór umowy, par. 2 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena ofertowa brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy: załącznik nr 9 par. 4 ust. 1 (wzór umowy)

Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt zgodny z zamówieniem na 15 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy: Załącznika nr 9 do SIWZ –par. 4 ust. 2d)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 4 ust. 2a), 2b), 2c)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego za każdy dzień zwłoki w dostawie / wymianie na towar zgodny z zamówieniem / niewadliwy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy: załącznik nr 9, wzór umowy, par. 4 ust. 2c

Prosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

DOTYCZY: ZAPISY SIWZ ORAZ WZORU UMOWY, ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 5 ust. 1

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.. Nieniszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2 - Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

DOTYCZY MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bardziej zaawansowanej technologicznie pompy z możliwością dostosowywania czasu pełnego cyklu w zakresie od 10 do 25min w zależności od wskazań medycznych oraz wyposażoną obok trybu zmiennego, stałego statycznego także w tryb maksymalnego wypełnienia z automatycznym przełączeniem w tryb zmienny po upływie kilkunastu minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2 - Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

DOTYCZY MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH

Czy ze względu na tańszą obsługę eksploatacyjno-serwisową materacy modułowych z każdą komorą wymienną (zabezpieczonych przed ich rozsuwaniem się) Zamawiający dopuści zaoferowanie takiego rozwiązania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2 - Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

DOTYCZY MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH

Czy ze względu na brak w wyposażeniu materaca poduszki antyodleżynowej, Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca realizującego podłączenie do poduszki jednakże bez wskaźnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające mechaniczną możliwość skracania i wydłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 52

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leżę oparte jest na konstrukcji pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych, którego konstrukcja przystosowana jest do mycia i dezynfekcji w centralnych stacjach mycia łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający może sprecyzować minimalny prześwit pod łóżkiem w przestrzeniach pod kolumnami, co jest istotne przy przejeżdżaniu przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, który na całej szerokości i długości posiada prześwit pod łóżkiem wynosi 8,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, Barierek boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, nie poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające sterowanie za pomocą dwóch pilotów przewodowych oraz centralnego panelu sterującego z możliwością montażu na szczytce łóżka. Piloty wyposażone w możliwość selektywnej blokady?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barierek boczne opuszczane i składane za pomocą dwóch rąk, posiadające jednostopniową regulację wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga co wydaje się oczywistym aby, łóżko posiadające system ważenia posiadało klasyfikację produktu w klasie Im, oraz aby producent lub dystrybutor posiadał stosowny certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG aneks II bez rozdziału (4) umożliwiające legalizację dostarczonego produktu na etapie produkcji, jak również na późniejszym etapie użytkowania łóżek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szerokość całkowita wraz z barierkami bocznymi wynosi 1030mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leżę oparte jest na konstrukcji pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych, którego konstrukcja przystosowana jest do mycia i dezynfekcji w centralnych stacjach mycia łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające bariereki boczne dzielone wykonane z profili aluminiowych spełniające normę bezpieczeństwa EN PN 60601-2-52 nie poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające sterowanie za pomocą pilotów przewodowych oraz panelu sterowniczego umieszczonego na szczycie łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację wysokości w zakresie 390 do 830 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację wysokości w zakresie 270 do 710 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację segmentu uda w zakresie od 0 do 40°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszczając sterowanie za pomocą pilota przewodowego opisanego w pkt. 12 dopuści aby funkcja autokontur realizowana była z panelu sterowniczego montowanego na szczycie oraz pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które funkcję autoregresji uzyskuje tylko poprzez ruch wsteczny tylko oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający przez wyłączniki blokady funkcji elektrycznych wymaga aby, łóżko posiadało dodatkowe sterowanie regulacji wysokości nożnej za pomocą sterowników nożnych? (pkt.23)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka wyposażonego w sterowanie nożne regulacji wysokości zabezpieczone przez nieumyślnym uruchomieniem.

Pytanie nr 69

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające system blokowania polegający na zwolnieniu przycisku w pilocie lub panelu sterującym. Regulacje funkcji elektrycznych występują tylko w momencie ich aktywacji przez wciśnięcie klawisza na pilocie przewodowym. W przypadku blokady funkcji na pilocie aby dokonać aktywacji funkcji na panelu sterującym należy użyć klawisza aktywującego panel sterujący. Wymuszający na personelu zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu zmiany położenia segmentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Dotyczy: Pakiet 2

Prosimy o podanie na jakiej wysokości leża ma być dokonywane obciążenie wynoszące min. 400kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające 4 koła o średnicy 150mm z centralną blokadą oraz funkcją jazdy na wprost

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Por. 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 220cm +/- 5cm z możliwością manualnego sterowania i wydłużania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością manualnego starowania i wydłużania ale o wymiarach zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 73

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Por. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 90cm +/- 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Por. 17 Czy Zamawiający dopuści regulację leża w zakresie:

- segmentu uda – 0-30°?

- segmentu podudzia – 0-30°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 75

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści barierki blokowane na dwóch różnych wysokościach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Poz. 29 Bardzo prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju wskaźników wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka wyposażonego we wskaźniki pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na segmentach leża.

Pytanie nr 77

Dotyczy: Pakiet 1 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści 6 uchwyty (haków) na akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

Dotyczy: pakiet nr 2 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 220cm +/- 5cm z możliwością wydłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79

Dotyczy: pakiet nr 2 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści regulacje elektryczną części nożnej w zakresie 35° +/- 5°

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80

Dotyczy: pakiet nr 2 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Poz. 24 czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa (oznaczonego charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) – realizującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze system odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81

Dotyczy: pakiet nr 2 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa (oznaczonego charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) – realizującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze system odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

Dotyczy: pakiet nr 2 Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

Poz. 38 Czy Zamawiający różko o obciążeniu w pozycji horyzontalnej min 270 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


II. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załączników SIWZ.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń pracowników (Pakiet nr 1, 2). Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 16.06.2014r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 16.06.2014r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

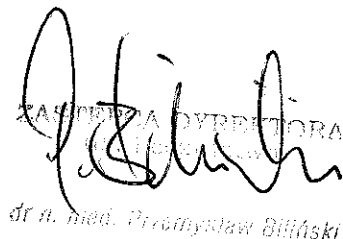

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr n. med. Przemysław Biliński



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmiana 03.06.2014r.
Nr sprawy 62/ZP/2014

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

PAKIET NR 1

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek wyspospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczane za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Pakiet nr 1: Łóżka wyspospecjalistyczne do terapii OIOM – 6 szt.

LP.	Parametry Wymagane	Warunek	Opisac	Odpowiedź oferenta
1.	Łóżko intensywniej opieki medycznej z wagą i przechyłkami na boki	Podać/model/ typ		
2.	Producent	Podać		
3.	Kraj pochodzenia	Podać		
4.	Rok produkcji min. 2014r. – fabrycznie nowe	Tak		
5.	zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazodka i uszkodzenia łóżka lub gniazodka	Tak		
6.	Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania	Tak		
7.	Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm	Tak		
8.	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu	Tak		
9.	Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego Konstrukcja zapewniająca przeświet pod łóżkiem min. 15 cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami	Tak-opisać		
10.	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających	Tak		
11.	Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu	Tak		
12.	Barierki boczne, tworzywowe, dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	Tak		
13.	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców	Tak,		
14.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-60°	Tak, Podać		
15.	Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta	Tak		
16.	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem	Tak		
17.	regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych - wysokości leża w	Tak,		

podpis osoby upoważnionej



	zakresie 40-80cm +/- 5 cm - segmentu uda w zakresie min 0 - 35 ° - segmentu podudzia min. 40° - wydłużania segmentu leża co najmniej o 15 cm - funkcji Trendelenburga i -antyTrendelenburga w zakresie min 0-12°		
18.	Autoregresja segmentu oparcia i uda	Tak	
19.	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego	Tak	
20.	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa poziomująca segmenty leża za pomocą jednego przycisku	Tak	
21.	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna za pomocą jednego przycisku	Tak	
22.	Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w bariery boczne z funkcjami selektywnej blokady. Przyciski - wodoodporne	Tak	
23.	Koła antystatyczne o śr. min. 150 mm z centralną blokadą uruchamianą jedną dźwignią	Tak	
24.	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka	Tak	
25.	Konstrukcja barier bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na różnych wysokościach. Bariery z możliwością zastosowania jako podparcie dla pacjenta przy wychodzeniu z łóżka	Tak	
26.	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności	Tak , podać	
27.	Możliwość wyświetlenia masy z dokładnością co najmniej 100g	Tak, Podać	
28.	Waga wyposażona w system autokompresji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak , by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian	Tak	
29.	Łóżko wyposażone we wskaźniki Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 220 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta	Tak, Podać	
30.	Łóżko wyposażone w: wieszak infuzyjny min. 2 haki, 8 uchwytów (haków) na akcesoria, 4 gniazda na statywy infuzyjne	Tak	
31.	Odbojniki w 4 narożach łóżka Uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta – min	Tak, podać	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

4				
32.	Materac powietrzny leczący odleżyny co najmniej do III stopnia	Tak, podać		
33.	Materac dostosowany wymiarami do wielkości leża pacjenta	Tak		
34.	Grubość materaca - co najmniej 15 cm	Tak, podać		
35.	Materac wyposażony w czujnik, pozwalający na zanurzenie pacjenta w materacu, zapewniając idealny współczynnik dystrybucji masy ciała pacjenta do powierzchni styku, a także zapewnia właściwe wsparcie dla ciała pacjenta, aby nie dotykało ono do ramy łóżka, co może powodować uszkodzenia skóry, zwłaszcza w okolicach kości krzyżowej	Tak,		
36.	Materac pracujący w trybie ciągłego niskiego ciśnienia	Tak		
37.	Materac z możliwością natychmiastowego uwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych, po kilku minutach - powraca automatycznie do trybu terapeutycznego	Tak		
38.	Zewnętrzna pompa z możliwością blokady panelu sterowania	Tak		
39.	Alarm przy braku zasilania - z możliwością wyciszenia. Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej - max 150 kg	Tak		
40.	Maksymalne obciążenie statyczne - 260 kg	Tak		
41.	Materac wyposażony w manualny zawór CPR	Tak		
1.	WARUNKI GWARANCJI			
2.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach - min. 24 miesiące	Tak, podać		
3.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” - max. 48 godzin - dotyczy dni roboczych	Tak, podać		
4.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	Tak		
5.	Maksymalnie trzy naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji po których niesprawny podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy	Tak, podać		
6.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max. 7 dni roboczych	Tak, podać		
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Tak		
8.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	Tak		
9.	SZKOLENIA			
1.	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić	Tak		

podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

	<p>szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewnianym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urzędzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin: 15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny każda;</p> <p>Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi, wykorzystania sprzętu.</p>			
--	---	--	--	--

podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmiana 03.06.2014r.
Nr sprawy 62/ZP/2014

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

PAKIET NR 2

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę łóżek wyspecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Pakiet nr 1: Łóżka wysokospecjalistyczne do terapii OIOM – 8 szt.

LP.	Parametry Wymagane	Warunek	Opisać	Odpowiedź oferenta
1.	Łóżko szpitalne do intensywnej opieki sterowane elektrycznie	Tak		
2.	Producent/Oferent	Podać		
3.	Kraj pochodzenia	Podać		
4.	Rok produkcji min. 2014r. – fabrycznie nowe	Tak		
5.	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci	Tak		
6.	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu oraz w sytuacjach zaniku napięcia	Tak		
7.	Długość zewnętrzna łóżka – 2160mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu	Tak, Podać		
8.	Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm)	Podać		
9.	Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami lub na pantografach.	Tak		
10.	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających	Tak		
11.	Barierki boczne, tworzywowe, dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	Tak		
12.	Sterowanie elektryczne funkcji łóżka za pomocą: paneli w barierkach bocznych, panelu sterowniczego na szczycie łóżka lub pilota przewodowego	Tak, Podać		
13.	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 335 mm do 735 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”	TAK, Podać		
14.	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75° +/- 5°	Podać		
15.	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50° +/- 5°	Podać		
16.	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg	Tak		
17.	Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn	Podać		
18.	regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 20° (+/- 5)	Tak, Podać		
19.	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy	Tak		

podpis osoby upoważnionej



	jednego przycisku na panelu sterowniczym			
20.	elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości uzyskania pozycji ratującej życie – sterowanie przy pomocy jednego przycisku	Tak		
21.	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości uzyskania pozycji ratującej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku	Tak		
22.	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - sterowań nożnych	Tak		
23.	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu	Tak		
24.	Odlączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po co najmniej 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)	Tak, Podać		
25.	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych.	Tak		
26.	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR	Tak		
27.	Koła tworzywowe o średnicy co najmniej 150mm blokowane centralnie gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Dodatkowe 5 koło kierunkowe blokowane do szybkiej jazdy.	Tak, Podać		
28.	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje. Obciążenie w pozycji horyzontalnej min 400kg	Tak		
29.	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami	Tak		
30.	Wypożenie	Tak		



	<ul style="list-style-type: none"> - Poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej - Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łóżka - Półka na pościel – wysuwana spod leża z możliwością chowania panelu sterowniczego - Wieszak do kropłówki 			
31.	MATERAC PRZECIODLEŻYNOWY	Tak		
32.	System pracy materaca zmiennociśnieniowy komory umieszczone w kilkunastu rzędach, napelniane i opróżniane w systemie 1:3, w stałym cyklu co 7,5 min.	Tak		
33.	Modułowa konstrukcja komór zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem.	Tak		
34.	Materac pozbawiony indywidualnych komór wydłużających czas czyszczenia materaca	Tak		
35.	Maksymalna waga pacjenta min. 160 kg	Tak, Podać		
36.	Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszana na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzonej we: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, wskaźniki podłączenia poduszki antyodleżynowej, wskaźnik konieczności wezwania serwisu, przycisk aktywowania i dezaktywowania akustycznych alarmów materaca, przycisk bezpieczeństwa – świadomego wyboru wybieranych funkcji, alarmu braku zasilania z stacji, alarm niskiego poziomu ciśnienia, wskaźnik CPR	Tak, Podać		
37.	Mechaniczna funkcja CPR – możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza	Tak		
38.	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa - przełączania się automatycznie po kilku minutach w tryb alternatywny(dynamiczny)	Tak		
39.	Możliwość pozostawienia w trybie transportowym do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego	Tak		
40.	Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego. Wysokość komór materaca – min. 16 cm.	Tak		
41.	Okablowanie materaca schowane wewnątrz systemu	Tak		
42.	Materac stosowany bezpośrednio na ramę łóżka, nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego	Tak		
43.	Materac pokryty zdejmowalnym półprzepuszczalnym pokrowcem paroprzepuszczalnym, zatrzymującym ciecze	Tak		



44.	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem	Tak	
WARUNKI GWARANCJI			
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	Tak, podać	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	Tak, podać	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	Tak	
4.	Maksymalnie trzy naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji po których niesprawny podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy	Tak, podać	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	Tak, podać	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Tak	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	Tak	
SZKOLENIA			
1.	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin: 15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny każda; Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi, wykorzystania sprzętu.	Tak	