

EZ.28.22. 313.2015MJ

Łódź, dn. 02.06.2015r  
Nr sprawy: 22/ZP/15

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i materiałów szewnych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

##### 1. dot. Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Pakietu nr 7:

1. Czy w Pakiecie Nr 7 Zamawiający w pozycji nr 1 ma na myśli zestaw składający się z:

- 2 wkładów o pojemności 60 ml
- złącza niskiego ciśnienia o dł. 250 cm z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym
- złącza szybkiego napełniania
- 2 ostrzy typu spike ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

##### 2. dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dział VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w kryterium oceny „Czas realizacji reklamacji” dla Pakietu 7 Zamawiający ma na myśli dni robocze?

**Zgodnie z § 5 REKLAMACJE ust. 1 Projektu Umowy dla Pakietu Nr 7 reklamacja ma być rozpatrzona w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji. Prosimy o potwierdzenie, że kryterium oceny w tym zakresie również będzie liczone w dniach roboczych.**

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

##### 3. dot. Projektu Umowy dla Pakietu Nr 7 – Załącznik nr 9 do SIWZ:

2. Dot. § 1 PRZEDMIOT UMOWY ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w zakresie 30% wartości umowy brutto całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.”

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Uzasadnienie: Zamawiający ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powinien wcześniej oszacować swoje potrzeby co do ilości potrzebnego asortymentu. 30% wartości umowy brutto powinno stanowić minimalne zobowiązanie Zamawiającego co do zakupu zamawianego asortymentu, aby nie powstała sytuacja, w której Zamawiający podpisuje z Wykonawcą „martwą” umowę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający we wzorze umowy oświadcza, iż oszacował ilość zamawianego towaru w należytej starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ze względu na losowy charakter zapotrzebowania nie jest w stanie określić minimalnej procentowej ilości, deklaruje jednakże dodatkowo, że zamówienia na towary będące przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą tylko na podstawie umowy zawartej w tym postępowaniu.**

**4.Dot. § 3DOKUMENTY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:**

„2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.”

Prosimy o wykreślenie tego ustępu. Magazyn, z którego wysyłany jest towar znajduje się poza siedzibą spółki a dokumenty dopuszczające do obrotu są wysyłane z siedziby spółki. Poza tym Zamawiający już na etapie przetargu będzie w posiadaniu kompletu wymaganych certyfikatów, ponieważ należy dołączyć je do oferty. Alternatywnie prosimy o możliwość wystania dokumentów dopuszczających do obrotu w dniu pierwszej dostawy towaru na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail.

W związku z powyższym prosimy o dodanie ustępu o następującej treści:

„Wykonawca prześle dokumenty dopuszczające do obrotu i używania przy pierwszej dostawie danego asortymentu na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, jednak dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów wraz z umową.**

**5.Dot. § 6KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości ~~10%~~5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

c/ za ~~opóźnienie~~**zwłokę** w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości ~~2%~~**1%** wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~**zwłoki** – chyba że nie ponosi winy;

d/ za ~~opóźnienie~~**zwłokę** w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości ~~2%~~**1%** wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~**zwłoki** – chyba, że nie ponosi winy.

e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości ~~10%~~**1%** wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy. – prosimy o zmniejszenie wysokości kary za niedostarczenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania; kara jest niewspółmierna do wydarzenia a Zamawiający powinien – zgodnie z licznym orzecznictwem KIO – miarkować kary umowne; Zamawiający może zweryfikować fakt posiadania lub nie aktualnych dokumentów dopuszczających również na podstawie innych źródeł informacji (np. bezpośrednio u producenta oferowanego asortymentu, w jednostkach certyfikujących).

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych **do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody**.

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

6. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni ponad termin płatności określony w §4 ust. 1,

7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ.**

**6. Doł. § 10 AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

„1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007, chyba że Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające certyfikację na zgodność z normą EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.

*Prosimy o modyfikację jw.. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w w/w postępowaniu posiadamy certyfikaty na zgodność z wymienionymi przez Zamawiającego normami, dlatego też nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych auditów. Pragniemy również nadmienić, że norma ISO 27001:2007 – doł. produkcji, wdrażania i serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych - nie ma zastosowania w przypadku w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę ~~Strony~~ w związku z realizacją niniejszej umowy, ~~Wykonawca powinien~~ **Strony powinny** traktować jako poufne. ~~Wykonawca zobowiązany jest~~ **Strony zobowiązane są** do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jaki jest wdrażany w WSS im. M. Kopernika w Łodzi, Szpital zobowiązany jest do przeprowadzania oceny dostawcy. Jednym ze sposobów przeprowadzania takiej oceny oraz nadzoru nad procedurą zakupów może być audit zewnętrzny, wykonywany przede wszystkim w firmach nie posiadających certyfikowanych systemów jakości. Jest to audit drugiej strony zwany audytem dostawcy. Ma to miejsce wówczas, gdy Szpital, występując w roli zamawiającego, przeprowadza audit u swoich aktualnych lub potencjalnych dostawców. W tym celu zostają określone kryteria, wg których audit jest przeprowadzany. Rodzaj i zakres takiego nadzoru określa Szpital, biorąc pod uwagę wiele czynników (rodzaj wyrobu, jego wpływ na jakość wyrobu gotowego itp.). Audit nie jest formą kontroli. Jest systematycznym i niezależnym procesem uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu spełnienia kryteriów auditu. Audit przeprowadzany jest przez zespół audytorów Szpitala. Dodatkową korzyścią wynikającą z prowadzenia auditów drugiej strony może być poprawa wzajemnego zrozumienia w zakresie stawianych wymagań jakościowych, a także możliwość pomocy w poprawie systemu jakości dostawcy. W rezultacie tego rodzaju auditów Szpital nabiera większego zaufania do swoich dostawców. W związku z powyższym wprowadzenie do**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**umowy zapisu, który daje możliwość przeprowadzenia przez Zamawiającego auditu u Wykonawcy nie stanowi żadnego utrudnienia dla Wykonawcy.**

7. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru do magazynu – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki;
- b) za dostarczenie do magazynu towaru z wadami lub niezgodnego z SIWZ – 0,5 % wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 4 % wartości brutto całej umowy.
- d) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 – 5 % wartości brutto umowy.

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przestana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy – zamiast faktury – dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wystania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.**

**8. Pyt. 1. Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 3:**


Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o wydzielenie w pakiecie nr 1 przewodników hydrofilnych. W celu przedłożenia oferty w tej samej pozycji prosimy o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o długościach: 150cm, 180cm oraz 260cm i średnicach: 0.032, 0.035 oraz 0.038" do dowolnego wyboru Zamawiającego z końcówką prostą i „J”, o dwóch stopniach twardości. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.**

**9. Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 3 i 4:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 3 i 4 i utworzenie odrębnego pakietu. W celu przedłożenia oferty w tej samej pozycji prosimy o dopuszczenie introducerów udowych w rozmiarach od 4 Fr do 11Fr o długościach do wyboru 10 cm i 23 cm. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu, z powodzeniem użytkowanym przez pracownie hemodynamiki, chirurgii naczyniowej, radiologii na terenie całej Polski. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.**

**10. Czy Zamawiający, w ramach pozycji 2 Pakietu 7, dopuści złożenie oferty na jednorazowe sterylne złącza Y, o długości 230-250 cm, dedykowane do badań rezonansu magnetycznego?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach złożenia oferty na cały pakiet nr 7 oferty na jednorazowe sterylne złącza Y, o długości 230-250 cm, dedykowane do badań rezonansu magnetycznego.**

11. W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, zwracamy się zapytaniem czy, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę na pakiet nr 7 przeprowadzali szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu stosowania sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

12. Czy Zamawiający, w ramach pozycji 2 Pakietu 7, dopuści złożenie oferty na jednorazowe sterylne złącza Y, o długości 230-250 cm, dedykowane do badań rezonansu magnetycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach złożenia oferty na cały pakiet nr 7 oferty na jednorazowe sterylne złącza Y, o długości 230-250 cm, dedykowane do badań rezonansu magnetycznego.**

Prosimy także o odpowiedź na pytania dotyczące Załącznika nr 9 do SIWZ, projektu umowy dla Pakietu nr 7:

13. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 1.b/ § 6 o treści (cyt.):

*b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;*

i nada mu proponowany zapis:

*b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto ?*

Uzasadnienie:

Kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę, żadnym mierze nie powinna obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

14. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 1.e/ § 6 o treści (cyt.):

*e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.*

i nada mu proponowany zapis:

e/ za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do ich niezwłocznego dostarczenia, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba że nie ponosi winy ?

Uzasadnienie:

Proponowana przez Zamawiającego kara jest znacząco wygórowana, szczególnie że *de facto* nie dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, a jedynie dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie RP wyrobów medycznych, będących przedmiotem umowy. Jednak nawet ze względu na fakt, że w/w dokumentacja jest ważna, nie można odmówić Wykonawcy prawa do bycia wezwanym czy upomnianym przez Zamawiającego do wywiązania się z ciążącego na Wykonawcy obowiązku przedłożenia stosownych certyfikatów.

Zwracamy także uwagę, iż ew. nakładana na Wykonawcę kara w żadnym wypadku nie może być naliczana od tej części umowy, która już wcześniej została rzetelnie zrealizowana.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

**14a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do pakietu **nr. 4 pozycja nr.1** produkt o następujących parametrach technicznych :

-Cewnik diagnostyczny radiologiczny zbrojony 4F,5F,6F z podwójnym oplotem, - średnica zewnętrzna 4,5,6F; -średnica wewnętrzna 1,03 mm dla 4F, 1,20mm dla 5F, 1,30mm dla 6F; -wytrzymałość ciśnienia 750 psi dla 4F, 1000psi dla 5F i 6F; -miękką atraumatyczną końcówką; - długość 65-110cm; -cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,038"; -krzywizny: Cobra( Small, Middle, Large), Sidewinder, Straight, Hinckheadhunter 1 i 2, Bentson-Hanafee 1 i 2, Vertebral, StraightPigtail Flush, Staright-Wilson.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

**15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do pakietu **nr. 4 pozycja nr 2** produkt o następujących parametrach technicznych:

-Cewnik diagnostyczny radiologiczny z pokryciem hydrofilnym , cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU, zewnętrzna powierzchnia wykonana z Poliuretanu; -końcówki pokryte hydrofilnie( M Polymer) na odcinku 15,25,40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika; -średnica 4F i 5F;- długość :65,80,100,110,120,150 cm;- akceptują przewodnik 0,038";- średnica zewnętrzna 4F (1,40mm) i 5F(1,70mm);- średnica wewnętrzna 4F -0,041"(1,03mm) i dla 5F-0,043"(1,10mm);- kontrola trakcji 1:1;- duży wybór krzywizn.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

**16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do pakietu **nr. 4 pozycja nr.3** produkt o następujących parametrach technicznych:

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





-Zestaw do nakłucia tętnicy udowej;- długość koszulki 10 i 25 cm;- zawiera introduktor, dylator i przewodnik 0,025", 0,035", 0,038";- średnica wewnętrzna :4F-10F, długość przewodnika:45 cm dla 10 cm koszulki i 80 cm dla 25 cm koszulki;- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem;- wyjątkowo cienkie ściana cieniująca wraz z rękawem antyzałamaniowym;- dylator zatraskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do pakietu nr. 4 pozycja nr.4 produkt o następujących parametrach technicznych:

-Zestaw do nakłucia tętnicy udowej zawiera introduktor, dylator i przewodnik 0,035", 0,038";- średnica wewnętrzna : 4F-9F, długość koszulki: 10 cm;- długość przewodnika 45 cm;- metalowa igła – 18G (1.2 x 70 mm);- kompatybilny przewodnik 0,035"(0,89mm) do 4F i 0,038"(0,97mm) do pozostałych; - gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem,wyjątkowo cienkie ściana cieniująca wraz z rękawem antyzałamaniowym;- dylator zatraskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

**II. Zamawiający dokonuje z mian w Zamawiający Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :**


**w zakresie terminów :**

- termin złożenia ofert do dnia .....<sup>M</sup>..... czerwca 2015r do godz. 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia .....<sup>M</sup>..... czerwca 2015r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu .....<sup>M</sup>..... czerwca 2015r o godz. 11:00

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Wojciech Szrajber

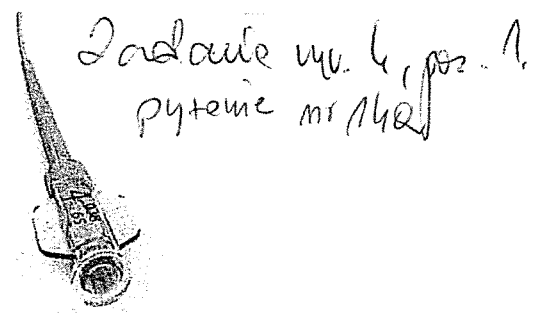

## Cewnik angiograficzny

Cewnik diagnostyczny jest przeznaczony do użytku w procedurach angiograficznych. Dostarcza on środki kontrastowe i lecznicze do wybranych miejsc w układzie naczyniowym. Stosowany jest także do doprowadzenia przewodnika lub cewnika do miejsca docelowego.

[Redacted], to kompletna linia cewników diagnostycznych, których doskonała kontrola obrotu oraz precyzyjne ułożenie zapewniają bezproblemowość procedur angiograficznych.

### Charakterystyka produktu

- Podwójnie pleciona siatka [redacted] zapewnia optymalną kontrolę obrotu oraz lepszą popychalność i stabilność cewnika
- Ultra cienka ściana cewnika tworzy duże światło, zapewniając wysoki przepływ środków kontrastowych, co zwiększa jakość wyników angiograficznych i skraca czas iniekcji
- Mięka, atraumatyczna końcówka minimalizuje ryzyko uszkodzenia ścian naczynia

### Ogólna specyfikacja

	Cisnienie graniczne	4 Fr (1.40 mm) – 750 psi / 5Fr (1.70 mm), 6 Fr (2.00 mm) – 1000 psi		
	Kompatybilny przewodnik	0.038" (0.97 mm)		
[redacted] Średnica zewn. (Fr / mm)		4 Fr / 1.40 mm	5 Fr / 1.70 mm	6 Fr / 2.00 mm
[redacted] Średnica wewn. (cale / mm)		0.041" / 1.03 mm	0.047" / 1.20 mm	0.051" / 1.30 mm

### Specyfikacja produktu

Nazwa	Kształt	Długość	Otwory boczne	Kod produktu wg rozmiaru	
[redacted]	[redacted]	65 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	80 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	65 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	80 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	80 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	65 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	65 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	80 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	65 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	90 cm	0	[redacted]	[redacted]


Nazwa	Kształt	Długość	Otwory boczne	Kod produktu wg rozmiaru	
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	4 Fr / 1.40 mm	5 Fr / 1.70 mm
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	100 cm	0	[redacted]	[redacted]

Inne numery kodowe [redacted] Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu. Po więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem [redacted]



Nazwa	Kształt	Długość	Boczne otwory	Kod produktu wg rozmiaru	
				4 Fr / 1.40 mm	5 Fr / 1.70 mm
[REDACTED]		65 cm	6	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		80 cm	6	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		65 cm	6	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		110 cm	6	[REDACTED]	[REDACTED]


Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu.  
 Inne numery kodowe dostępne. Po więcej informacji, prosimy o kontakt z przedst. [REDACTED]



## Hydrofilny cewnik angiograficzny

Zardane m. 4, pos. 2

pytanie nr 15



R- [redacted] to hydrofilny cewnik angiograficzny przeznaczony do cewnikowania obwodowego i neuronaczyniowego, do wykorzystania w obwodowych i neuronaczyniowych procedurach angiograficznych.

Dostarcza on środki kontrastowe i lecznicze do wybranych miejsc w układzie naczyniowym.

Stosowany jest także to wprowadzania przewodnika lub cewnika do miejsca docelowego.


[redacted] oparty jest na tym samym hydrofilnym pokryciu, co przewodnik [redacted], które pozwala na dotarcie do odleglejszych punktów w najbardziej krętych naczyniach.

[redacted] służy również do dostarczania materiałów do embolizacji, takich jak sfery, cząsteczki PVA i spirale.



### Charakterystyka produktu

- Dystalne pokrycie hydrofilne 15 – 25 – 40 cm w zależności od typu i długości cewnika zapewnia doskonałe manewrowanie oraz pozwala selektywnie cewnikować najbardziej kręte naczynia
- Wyjątkowa budowa oplotu: pojedynczy oplot dla 5 Fr, podwójny oplot dla 4 Fr zapewniają doskonałe przeprowadzanie, szczególnie w połączeniu z przewodnikami hydrofilnymi [redacted]
- Gładka powierzchnia cieniująca zapobiega tworzeniu się skrzepin i zapewnia wysoką widzialność w skopii.
- Wyższe światło dla niższego profilu, [redacted] 4 Fr (1.40 mm) wraz z przewodnikiem 0.038" (0.97mm) może być użyty jako cewnik prowadzący dla mikrocewnika takiego jak [redacted]
- Wysoka odporność na ciśnienie: 750 psi (5.171 kPa) dla 4 Fr i 1000 psi (6.895 kPa) dla 5 Fr.
- Dostępne specjalne zakrzywienia i długości, takie jak prosty 150 cm do rekanalizacji kończyn dolnych oraz kształt Yashiro 3D do łatwiejszego dostępu do pnia trzewnego.



### Ogólna specyfikacja

Dostępne średnice	4 Fr oraz 5 Fr
Plaszcz cieniujący	Polyurethane
Hydrofilne pokrycie	Polimer „M”
Powierzchnia wewnętrzna	Wzbogacona Nylonem
Średnica wewn. 4 Fr	0.041" (1.03 mm)
Średnica wewn. 5 Fr	0.043" (1.10 mm)
Długości (cm)	65, 80, 100, 110, 120, 150
Kompatybilny przewodnik	0.038" (0.97 mm)
Sztuk w pudełku	5



Specyfikacja produktu - [REDACTED]

Srednica zewn.	Długość	Długość końcówki hydrofilnej	Kształt końcówki	Boczne otwory	Kod produktu
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	Cobra Small	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	80 cm	15 cm	Cobra Small	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Cobra Small	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	80 cm	40 cm	Cobra Small	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	80 cm	40 cm	Cobra Small	2	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	80 cm	15 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	80 cm	40 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Cobra Middle	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	Cobra Large	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	80 cm	15 cm	Cobra Large	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Cobra Large	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	80 cm	40 cm	Cobra Large	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	J curve Large	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	J curve Large	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	70 cm	25 cm	Yashiro	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	Straight	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	80 cm	15 cm	Straight	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Straight	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	110 cm	15 cm	Straight	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	120 cm	15 cm	Straight	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	150 cm	40 cm	Straight	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	40 cm	25 cm	Straight	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	110 cm	40 cm	Straight	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Straight tapered	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	80 cm	40 cm	Straight tapered	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Straight tapered	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	65 cm	15 cm	Non-tapered angled	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Non-tapered angled	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	110 cm	15 cm	Non-tapered angled	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	150 cm	40 cm	Non-tapered angled	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	110 cm	40 cm	Non-tapered angled	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Non-tapered angled type T90	2	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	65 cm	25 cm	Angled tapered	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Angled tapered	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	110 cm	15 cm	Multipurpose	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Multipurpose	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	80 cm	15 cm	COE 2	5	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Internal Mammary short tip	0	[REDACTED]

Specyfikacja produktu - [REDACTED]


Srednica zewn.	Długość	Długość końcówki hydrofilnej	Kształt końcówki	Boczne otwory	Kod produktu
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Simmons / Sidewinder 1	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Simmons / Sidewinder 1	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Simmons / Sidewinder 2	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Simmons / Sidewinder 2	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Simmons / Sidewinder 3	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Hinck Headhunter 1	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Hinck Headhunter 1	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Bentson-Hanafee-Wilson 1	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Bentson-Hanafee-Wilson 1	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Bentson-Hanafee-Wilson 2	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Bentson-Hanafee-Wilson 2	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	110 cm	15 cm	Bentson-Hanafee-Wilson modified	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	MANI	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	100 cm	15 cm	Vertebral	0	[REDACTED]
4 Fr / 1.40 mm	120 cm	15 cm	Vertebral	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	100 cm	40 cm	Vertebral	0	[REDACTED]
5 Fr / 1.70 mm	110 cm	40 cm	Vertebral	0	[REDACTED]

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu




# Zestaw standardowy

## Introduktor



### Charakterystyka produktu

- Unikalna zastawka utrzymuje całkowitą hemostazę, aby uniknąć krwawienia i zasysania powietrza
- Gładkie przejście między koszulką i rozszerzaczem oraz jego stożkowy kształt zmniejszają opór podczas wprowadzania
- Wyjątkowo cienka ściana cieniująca wraz z rękawem antyzalaminowym zapewniają doskonałą obsługę cewnika
- Rozszerzacz zatraskowy zapobiegający wysuwaniu się podczas wprowadzania oraz umożliwiający jednoręczne odłamanie



### Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm
Miniprowadnik	Plastikowy prosty i zagięty 0.025" (0.64 mm) dla 4 Fr. 0.035" (0.89 mm) dla pozostałych 45 cm
Igła wprowadzająca	Plastikowa kaniula - 18G x 2 1/2" (1.2 x 64 mm), oprócz 4 Fr.: 20G x 2" (0.9 x 51 mm), 2.5 ml strzykawka w zestawie
Kompatybilny prowadnik	0.025" (0.64 mm) dla 4 Fr 0.035" (0.89 mm) dla pozostałych
Opakowanie	Taca

### Dostępne zestawy

- Zestaw A zawiera koszulkę, rozszerzacz, plastikowy miniprowadnik oraz plastikową kaniulę wprowadzającą
- Zestaw C zawiera koszulkę i rozszerzacz
- Zestaw B zawiera koszulkę, rozszerzacz, plastikowy lub stalowy miniprowadnik
- Zestaw R zawiera koszulkę, rozszerzacz, stalowy miniprowadnik i igłę wprowadzającą

*pytemic 16*



### Zestaw B

Rodzaj 1. Na tacy z plastikowym miniprowadnikiem

### Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm i 25 cm
Miniprowadnik	Plastikowy prosty i zagięty 0.025" (0.64 mm) or 0.035" (0.89 mm) dla 4 Fr and 0.038" (0.97 mm) dla pozostałych 45 cm dla 10 cm koszulki 80 cm dla 25 cm koszulki
Kompatybilny prowadnik	0.025" (0.64 mm) lub 0.035" (0.89 mm) dla 4 Fr i 0.038" (0.97 mm) dla pozostałych
Opakowanie	Taca

*Zadanie nr 4 par. 3*

### Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Typ miniprowadnika	
	45 cm zagięty	45 cm prosty
4 Fr	RS+A40K10AQ RS+A40K10AQ	RS+A40K10SQ RS+A40K10SQ
5 Fr	RS+A50K10AQ RS+A50K10AQ	RS+A50K10SQ RS+A50K10SQ
6 Fr	RS+A60K10AQ RS+A60K10AQ	RS+A60K10SQ RS+A60K10SQ
7 Fr	—	RS+A70K10SQ RS+A70K10SQ
8 Fr	—	RS+A80K10SQ RS+A80K10SQ
9 Fr	—	RS+A90K10SQ RS+A90K10SQ
10 Fr	—	RS+A10K10SQ RS+A10K10SQ
11 Fr	—	RS+A11K10SQ RS+A11K10SQ

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu

### Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Kompatybilny prowadnik	Koszulka 10 cm		Koszulka 25 cm
		45 cm zagięty	Typ miniprowadnika	
			45 cm prosty	80 cm zagięty
4 Fr	0.025" (0.64 mm)	—	RS+A40K10SQ RS+A40K10SQ	—
4 Fr	0.035" (0.89 mm)	—	RS+A40K10SQ RS+A40K10SQ	—
5 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A50K10SQ RS+A50K10SQ	—
6 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A60K10SQ RS+A60K10SQ	—
7 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A70K10SQ RS+A70K10SQ	—
8 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A80K10SQ RS+A80K10SQ	—
9 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A90K10SQ RS+A90K10SQ	—
10 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A10K10SQ RS+A10K10SQ	—
11 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+A11K10SQ RS+A11K10SQ	—

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu



Rodzaj 2. Na tacy ze stalowym miniprowadnikiem

Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm
Miniprowadnik	Sprężynowy, podwójna końcówka – Prosta i J 0.035" (0.89 mm) i 0.038" (0.97 mm) 45 cm
Kompatybilny przewodnik	0.035" (0.89 mm) lub 0.038" (0.97 mm)
Opakowanie	Taca

Rodzaj 3. W torebce ze stalowym miniprowadnikiem

Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm
Miniprowadnik	Sprężynowy, podwójna końcówka – Prosta i J 0.035" (0.89 mm) do 4 Fr 0.038" (0.97 mm) do pozostałych 45 cm
Kompatybilny przewodnik	0.035" (0.89 mm) i 0.038" (0.97 mm)
Opakowanie	Torebka

Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Kompatybilny przewodnik	
	0.035" (0.89 mm)	0.038" (0.97 mm)
4 Fr	[REDACTED]	—
5 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
6 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
7 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
8 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
9 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
10 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]
11 Fr	[REDACTED]	[REDACTED]

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu

Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Kod produktu
4 Fr	[REDACTED]
5 Fr	[REDACTED]
6 Fr	[REDACTED]
7 Fr	[REDACTED]
8 Fr	[REDACTED]
9 Fr	[REDACTED]
10 Fr	[REDACTED]
11 Fr	[REDACTED]

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu

*pytać NF*



Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm i 25 cm
Kompatybilny przewodnik	0.025" (0.64 mm), 0.035" (0.89 mm) do 4 Fr, a 0.038" (0.97 mm) do pozostałych
Opakowanie	Torebka



Ogólna specyfikacja

Długość koszulki	10 cm
Miniprowadnik	Sprężynowy, podwójna końcówka – Prosta i J 0.035" (0.89 mm) for 4 Fr and 0.038" (0.97 mm) for all others 45 cm
Igła wprowadzająca	Metalowa - 18G x 2 3/4" (1.2 x 70 mm)
Kompatybilny przewodnik	0.035" (0.89 mm) do 4 Fr 0.038" (0.97 mm) do pozostałych
Opakowanie	Taca

*Zadanie nr 4, pos. 4*

Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Kompatybilny przewodnik	Długość koszulki	
		10 cm	25 cm
4 Fr	0.025" (0.64 mm)	[REDACTED]	—
4 Fr	0.035" (0.89 mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
5 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	—
6 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
7 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
8 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
9 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	—
10 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	—
11 Fr	0.038" (0.97 mm)	[REDACTED]	—

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu

Specyfikacja produktu

Średnica wewn.	Kod produktu
4 Fr	[REDACTED]
5 Fr	[REDACTED]
6 Fr	[REDACTED]
7 Fr	[REDACTED]
8 Fr	[REDACTED]
9 Fr	[REDACTED]

Prosimy o używanie powyższych oznaczeń przy zamawianiu

