

EZ.28.34.1232.2019.AO

Łódź, dnia 01.08.2019 r.

Nr sprawy EZ.28.34.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I Zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników do odsysania w systemie zamkniętym o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- długość 60cm
- rozmiary CH 14, 16
- do każdego zestawu dołączone 20 sztuk fiolek 10ml 0,9% NaCl kompatybilnych z portem do płukania cewnika

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pakiet 2, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników do odsysania w systemie zamkniętym o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturką zamocowaną do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką tracheostomijną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- długość 34cm
- rozmiary CH 14, 16
- do każdego zestawu dołączone 20 sztuk fiolek 10ml 0,9% NaCl kompatybilnych z portem do płukania cewnika


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



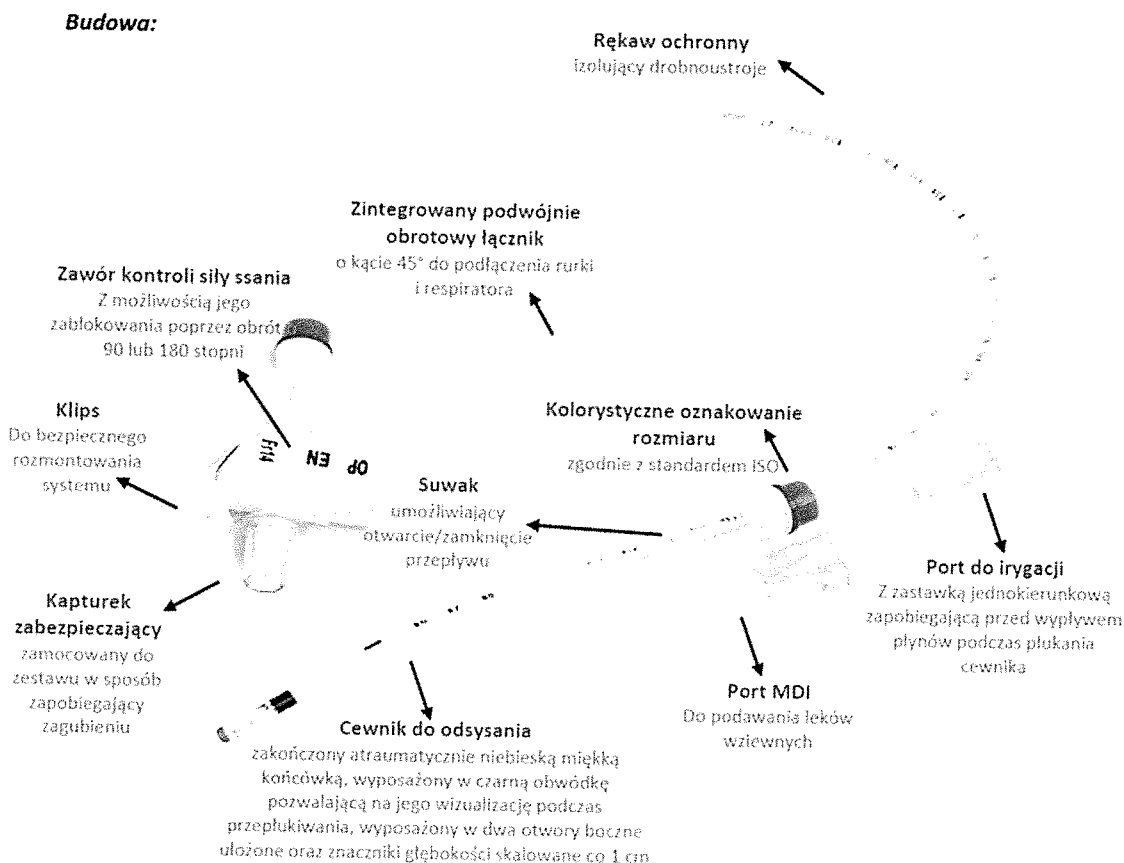

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pakiet 1,

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki w opisie urządzeń przewidzianych do dzierżawy w pakiecie 1. oraz potwierdzenie, jakiego rodzaju rządzenia Zamawiający planuje wydzierżawić.

W załączniku nr 2 do EZ.28.34.2019SIWZ – „ oferta - formularz cenowy”, w pozycji 14. napisano:
„Dzierżawa urządzenia do podawania kontrastu- wstrzykiwacz kontrastu do diagnostyki CT / tomografia komputerowa/ - SZTUK - 7. Kompatybilny z asortymentem z pozycji 1 - 4.”
podczas gdy następujący poniżej opis funkcji/parametrów urządzeń zdecydowanie wydaje się odnosić do urządzeń do ciągłej terapii nerkozastępczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją.

Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pakiet 1 pozycja 11:

W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania przez producenta prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie adsorberów o wymaganej charakterystyce w opakowaniach a'1 sztuka w miejsce opakowania a'6 sztuk. Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania łącznie 15 sztuk adsorbera czy też 15 x 6 sztuk (czyli 90 sztuk łącznie).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 poz. 11 zaferowanie adsorberów pakowanych a'1 szt. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zamawiał towar jako wielokrotności najmniejszego opakowania zbiorczego. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaferowania łącznie 15 szt. adsorbera

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi, (2)
mgr Wojciech Szrajber