

EZ.28.15.939.2021.KJB

Łódź, dnia 14.06.2021r.  
Numer sprawy: EZ.28.15.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2, 3, 6 oraz 137 ust. 2, 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

**1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

**Pytanie 1**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 4 pozycja 1 Zestaw do konikotomii Melker do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi: cewnik z mankietem o śr. wewnętrznej 5mm, śr. zewnętrzna 7,2mm długość 9cm, Ekstrasztynowy przewodnik wspomagający Amplatz o średnicy 0,038 inch, długość 40cm, Taśma tracheostomijna, 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 18 G, zakrzywiony Rozszerzacz, miniaturowy Skalpel nr 15, Strzykawka 6ml, Czerwony pojemnik na zużyte igły. Całość sterylna na podwójnej tacy. Naklejki do wklejania do protokołu.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 2**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 4 pozycja 2 Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez, Strzykawkę, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 3,5mm dł. 3,8cm lub 4mm, dł. 4,2cm, Taśmę tracheotomijną.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957




Pytanie 3

Pakiet nr 1, Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawów do nefrostomii 14.0 Fr, dł. 30 cm, składających się z: cewnika z końcem typu pigtail, igły EchoTip z mandrynem, przewodnika Safe-T-J z ze stali nierdzewnej pokrytego PTFE, rozszerzaczy, dwóch mandrynów prostujących, rurki łączącej z kranikiem jedno drożnym oraz podpórki cewnika?


Poniżej zdjęcie oraz wizualizacja części składowych zestawu:

Nephrostomy catheters and sets



**Zestaw wprowadzający cewnika do drenażu z pętlą Universa®**

Zestaw wprowadzający cewnika do drenażu z pętlą Universa® Służy do przezskórnego drenażu moczowodu z poziomo układu moczowo-płciowego. Zestaw zawiera cewnik z pętlą, igłę EchoTip z mandrynem, zakrzywiony przewodnik Safe-T-J ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, rozszerzacz, dwa mandryny prostujące, rurkę łączącą z kranikiem jedno drożnym oraz podpórki cewnika.

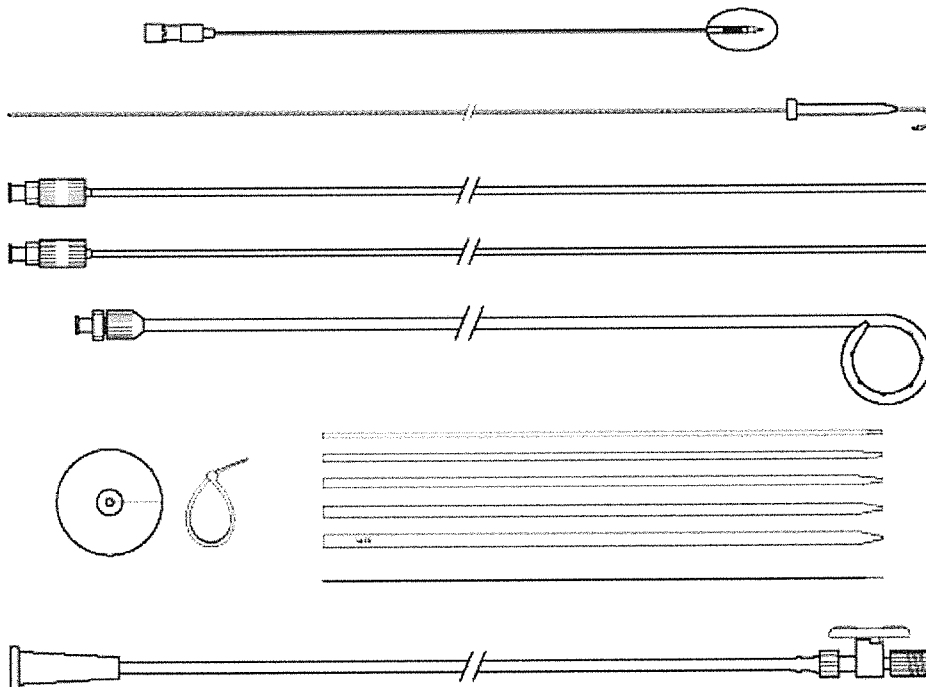

**ODPOWIEDŹ:**


Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Pytanie 4**

**Pakiet 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku, załadowanych, (oraz adekwatnych ładunków), o długości cięcia 100mm, długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych obłych zszywek. Wysokość zszywek 3,85mm (1,5mm po zamknięciu) lub 4,5mm (2,0mm po zamknięciu) do wyboru przez Zamawiającego. Staplery z ruchomą dźwignią spustową umożliwiającą odpalenie staplera z obu stron. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk do otwierania staplera.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 5**

**Pakiet 2 poz. 1**

Czy w Pakiecie nr 2 poz. nr 1 Zamawiający dopuści sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem o długości 15 cm, umożliwiający 360 stopni retrakcji, długość linii cięcia: 2-4 cm (rozmiar XS) i 2,5-6 cm (rozmiar S) i w rozmiarze M (długość cięcia 5-9 cm), długość poliuretanu 15 cm, w rozmiarze L (długość cięcia 9-14 cm), długość poliuretanu 25 cm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Opakowania po 5 szt.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 6**

**Pakiet 6 poz. 1**

Czy w Pakiecie nr 6 poz. nr 1 Zamawiający uzna za spełniające wymagania staplery o wysokości zszywek i lokalizacji noża tak jak dla wariantu pierwszego oraz spełniające pozostałe parametry tak jak dla wariantu trzeciego tj:

- jednorazowy, sterylny, załadowany stapler liniowy z nożem stanowiącym część ładunku o długości 100 mm, cztery rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm), posiadający pozycję częściowego zamknięcia, umożliwiający wypozyjonowanie tkanki przed zespoleniem, zabezpieczenie przed odpaleniem staplera jeśli dźwignia nie jest w pełni zamknięta bądź jeśli ładunek jest przestrzelony lub wystrzelony.

W razie odmowy żądamy podania merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**


Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Pytanie 7**

**Pakiet 6 poz. 2**

Czy w Pakiecie nr 6 poz. nr 2 Zamawiający uzna za spełniające wymagania ładunki o wysokości zszywek i lokalizacji noża tak jak dla wariantu pierwszego oraz spełniające pozostałe parametry tak jak dla wariantu trzeciego tj:

- jednorazowy sterylny ładunek o długości 100 mm, cztery rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm).

W razie odmowy żądamy podania merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 zestaw ratunkowy do konikotomii firmy [REDACTED] wg. następującego opisu :

ELEMENTY ZESTAWU • rurka do konikotomii • silikonowa przestrzeń martwa • skalpel • strzykawka jednorazowa i wygodna opaska szyjna dołączona do rurki dla dorosłych i dla dzieci .

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §2 zał. 8A)

**UMOWA PRZECHOWANIA**

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

..... z siedzibą w ....., ul  
wpisaną do rejestru po numerem .....  
reprezentowaną przez:

.....,  
zwanym dalej Przechowawcą


a  
....., z siedzibą w ....., ul .....

wpisaną do rejestru pod numerem .....

reprezentowaną przez :

1. ....
2. ....

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



zwaną w dalszej części umowy Składającym.

#### §1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ..... w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ..... na Oddziale ....., które znajduje się w ....., ..... – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan .....
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan .....

#### §2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

#### §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

#### §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

#### §5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

#### §6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ..... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

#### §7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

#### §8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

#### §9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

#### §10


1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od .....

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

**§11**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

**§12**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

**§13**

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez .....

**§14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

**RAPORT O ZUŻYCIU .....**

Proszę przestać pod numer faxu


TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )
- A)
- B)
4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §2 zał. 8A)

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 11**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

**Dot. zał. nr 8A**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - c) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



- d) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru – chyba że nie ponosi winy;
- e) za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji – chyba, że nie ponosi winy
- f) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty – chyba, że nie ponosi winy;
- h) za zwłokę w dostarczeniu faktury Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dostarczenia faktury licząc od daty dostarczenia partii towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej w terminie partii towaru

**dot. zał. nr 8B**


- 1.1. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1.;
- 1.2. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru
- 1.3. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji
- 1.4. za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 13 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 14**

W związku z zapisem § 13 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2020 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok

**ODPOWIEDŹ:**

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.03.2021 roku

1. Aktywa trwałe	207 811 110,91 zł
2. Aktywa obrotowe	80 798 349,69 zł
3. Suma pasywów	288 609 460,60 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	400 449 203,92 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	155 733 886,19 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 905 364,87 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	27 375 284,41 zł

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Pytanie 15**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 16**

**Dotyczy pakietu 6 STAPLERY tnące duże**

Czy Zamawiający za spełniające wymagania opisane w zdaniu pierwszym poz.1 pakietu 6 Zamawiający uzna urządzenia spełniające poniższe warunki:

Jednorazowy sterylny stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105 mm z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem (po zamknięciu 1.5mm) lub 4.5mm (po zamknięciu 2.0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony, systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia; po odpaleniu staplera nóż chowa się w zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 17**

**Dotyczy pakietu 6 STAPLERY tnące duże**

Czy Zamawiający za spełniające wymagania opisane w zdaniu pierwszym poz.2 pakietu 6 Zamawiający uzna urządzenia spełniające poniższe warunki:

ładunek sterylny do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu oraz zszywki o wysokości 4,5mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu, systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia; po odpaleniu staplera nóż chowa się w zabezpieczającą pochewkę .

**ODPOWIEDŹ:**


Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Pytanie 18**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 3 ze względu na rodzaj wykonywanych zabiegów i różnice anatomiczne pacjentów będzie wymagał, aby poprzeczki do usztywnienia stabilizacji dostępne były w trzech rodzajach – prosta, prosta o niskim profilu wystająca maksymalnie 6.2mm powyżej pręta oraz poprzeczka umożliwiająca kątowe zaczeplenie do prętów pokrywające zakres rozstawu prętów od 24mm do 97mm?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 5 ze względu na rodzaj wykonywanych zabiegów i różnice anatomiczne pacjentów będzie wymagał, aby długości prętów do stabilizacji pokrywały zakres od 30mm do 600mm i były dostępne w przynajmniej dwóch średnicach, co zapobiegnie dyskwalifikacji pacjentów do zabiegu?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 6 ze względu na rodzaj wykonywanych zabiegów będzie wymagał, aby zaoferowane śruby pokrywały zakres średnic od 4mm do 8.5mm i zakres długości od 25mm do 90mm, co znacząco zwiększy możliwość dopasowania implantu do anatomii pacjenta oraz zwiększy bezpieczeństwo zabiegu?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**Pytanie 21**

Dotyczy par. 3 ust. 3 Umowy komisowej (załącznik 8A do swz): czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty, ze względu na liczbę stron, zostały dostarczone w formie elektronicznej?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia warunków dostarczenia dokumentów określonych w §3 ust. 3 umowy komisowej (załącznik nr 8A do SWZ).

**Pytanie 22**

Dotyczy par. 8 Umowy komisowej: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach:

- a. zastąpienie produktów będących przedmiotem umowy produktami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie

w przypadku wprowadzenia nowego produktu stanowiącego odpowiednik produktu będącego przedmiotem umowy

- b. zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych w ramach realizacji niniejszej Umowy produktami o wyższej jakości, w przypadku dostępności na rynku takich produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu
- c. dodanie numeru katalogowego produktów w przypadku, gdy produkty o dodawanym numerze katalogowym spełniają wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a cena produktów o dodawanym numerze katalogowym nie jest wyższa niż cena produktów będących podstawą wyboru oferty Wykonawcy, a gdy kryterium wyboru produktów była jakość, produkty o dodawanym numerze katalogowym musi być co najmniej takiej samej jakości, jak produkty, będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy?


**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**2. Zamawiający dokonuje modyfikacji:**

**Terminy:**

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale XXIV pkt. 2 SWZ – na dzień 30.06.2021r. do godziny 10:00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXV pkt. 1 SWZ – na dzień 30.06.2021r. o godzinie 11:00
- c) Termin związania ofertą określony w rozdziale XXI pkt. 1 SWZ - na dzień 24.09.2021r.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Dział Zamówień Publicznych  
INSPEKTOR

  
mgr Karolina Janiczek-Borowiecka